

铁岭县腰堡镇卫生院设备准入





SONTU
Medical Imaging

深圳市深图医学影像设备有限公司

X射线管组件

型号：SAT-TUB50

安全类型：I类B型

S/N：1610186

焦点：0.6/1.2mm

等效滤过：2.5mmAL/75kV

最大管电压：150kV

生产日期：2017-02-26


联系方式：400-999-7609



生产厂商：SANTU Digital Technology Co.,LTD

地址：深圳市宝安区西乡街道九围社区洲石路旁三（1）队工
业区C栋厂房一楼

其它内容详见说明书

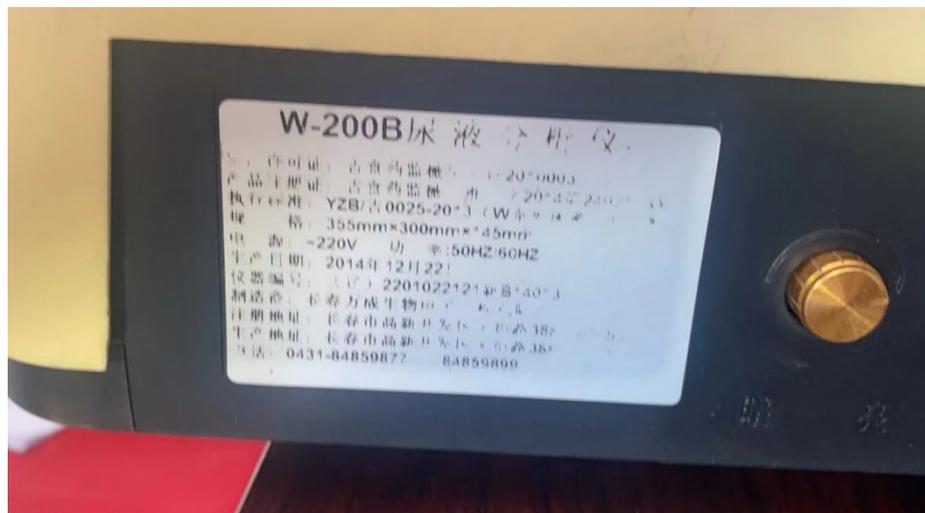



POWER RST

21M

超声经颅多普勒血流分析仪

Kejin®



型号: KJ-2V4型 编号: 160213
电源: 220V~ 50Hz 300VA
生产日期: 2016.02.19 使用期限: 五年
标准号: YZB/国4599-2012
注册号: 国食药监械(准)字2012第3230994号(更)

南京科进实业有限公司制造

SD/MMC



RESET





日期：2019年7月
生产企业名称：迪瑞医疗科技股份有限公司
地址：中国·长春
生产企业住所：长春市高新技术产业开发区
地址：长春市高新技术产业开发区宜居路3333号
电话：4008116695 4008116605 使用期限

